



רשימת אלומיניום

מרפאת ספיר

10.03.26

מהדורה 1

ביצוע




מכרז



עיון



רשימת אלומיניום אל 1	שם האלמנט	חלון דריי קיפ		מיקום	חדרים
	עבור פרוייקט	מרפאת ספיר			
	קנ"מ	1:50	תאריך	פתח בניה	110/132

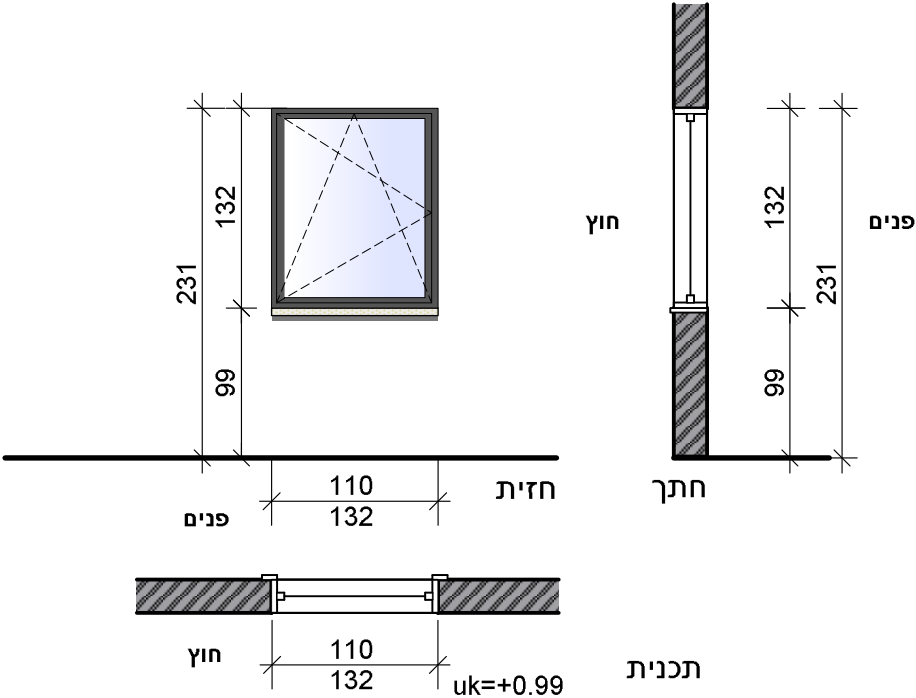

תאור החלון	חלון + סורגים על פי קיים במבנה
פרופיל	
זיגוג	
פרזול ואביזרים	
צבע	

שם האלמנט		מיקום	חדרים	רשימת אלומיניום
חלון תצפית ממוגן בין חדרים				אל 2
עבור פרויקט				
מרפאת ספיר				
קנ"מ	1:50	תאריך	פתח בניה	130/80

הנחיות מיגון קרינה לחדרי צילום

קירות פנימיים:

מיגון שווה ערך ל- 1.5 מ"מ עופרת לפחות, מהרצפה עד לגובה התקרה (ולא פחות מגובה של 2.50 מ').

דלתות:

(בכניסה לחדר, בחדרונות הלבשה, בשירותים צמודים לחדר וכ"ו) – מיגון שווה ערך ל- 1.0 מ"מ עופרת לפחות. דלת כניסת הנברקים לחדר הרנטגן תצויד בקפיץ מחזיר וידית הנמאפשרת פתיחה מתוך החדר בלבד.

משקופים:

יש להשתמש במשקופי מתכת בלבד. במידה וקיים חוסר חפיפה בין חלקי המגן, יש להוסיף עופרת וליצור חפיפה.

תקרה:

בדרך כלל אין דרישה לתוספת מיגון.

רצפה:

ברצפה דרוש מיגון שווה ערך ל 1.5 מ"מ עופרת לפחות, על השטח שמעליה מתאפשרת תנועת השפופרת, בתוספת 25 ס"מ מכל צד. בקומות קרקע ללא טרתי לא דרוש מיגון רצפה

בוקי בעמידה:

מיגון של לוח עופרת בעובי 2 מ"מ, במידות 125x125 ס"מ, מוצמד לקיר בגובה 60 ס"מ מהרצפה (בבוסף למיגון הקיר עצמו). מיגון כזה יותקן גם בכל מקום בו עלולה לפגוע קרינה ישירה

קיר מגן לחדר הפעלה (הפינה לחדר הרנטגן):

מיגון שווה ערך ל- 2 מ"מ עופרת לפחות, מהרצפה עד לגובה התיקרה (ולא פחות מגובה של 2.5 מ'). כל חלון בקיר זה ימוגן בזכוכית שוות ערך ל- 2 מ"מ עופרת.

עמדת הפיקוד:

גודל זכוכית המגן בחא הפיקוד לא יהיה קטן מ- 60x80 ס"מ. מיגון הקיר והחלון שווה ערך ל- 2.0 מ"מ עופרת לפחות. מיגון הקיר מהרצפה עד לגובה התיקרה (לא פחות מגובה של 2.50 מ'). (תשומת לב מיוחדת יש להפנות לחפיפה הנדרשת במיגון בין החלק לבין הקיר עצמו). גודל החלון והיקתו חייב לאפשר לרנטגנאי תצפית טובה לכל כיוון ולזווטי בחדר הרנטגן.

אם עמדת פיקוד נמצאת בתוך חדר הרנטגן עצמו, יש להגן עליה במחיצת מיגון שווה ערך ל- 2 מ"מ עופרת, שגובהה 2.5 מ' ורוחבה 1.2 מ' לפחות. רצוי שהמחיצה תחובר בצידה האחד לקיר ובצידה השני תהיה כנף באותו גובה וברוחב 80 ס"מ לפחות. אם המחיצה לא תחובר לקיר, אזי יהיו לה כנפיים כנ"ל משני הצדדים. במחיצה יותקן חלון בעל איתם כתמים ותכונות כמו חלון חדר הפעלה

— ~~RP~~ — מיגון קרינה עופרת 1.5 מ"מ או שווה ערך

לצורך מיגון בפני קרינה בכל הנושאים הנ"ל, ניתן להשתמש בעופרת, או (בבטוח מחזין ביציפות של 2.35 mc/g), לצורך חלונות ניתן להשתמש בזכוכית עופרת.

1 מ"מ עופרת שווה ל- 8 ס"מ בטון מחזיק בצפיפות הנ"ל.